

广州检验检测认证集团有限公司

检测报告

报告日期:

2019年10月31日




广州检验检测认证集团有限公司

1923


委托单位:

检测日期:

委托单号:

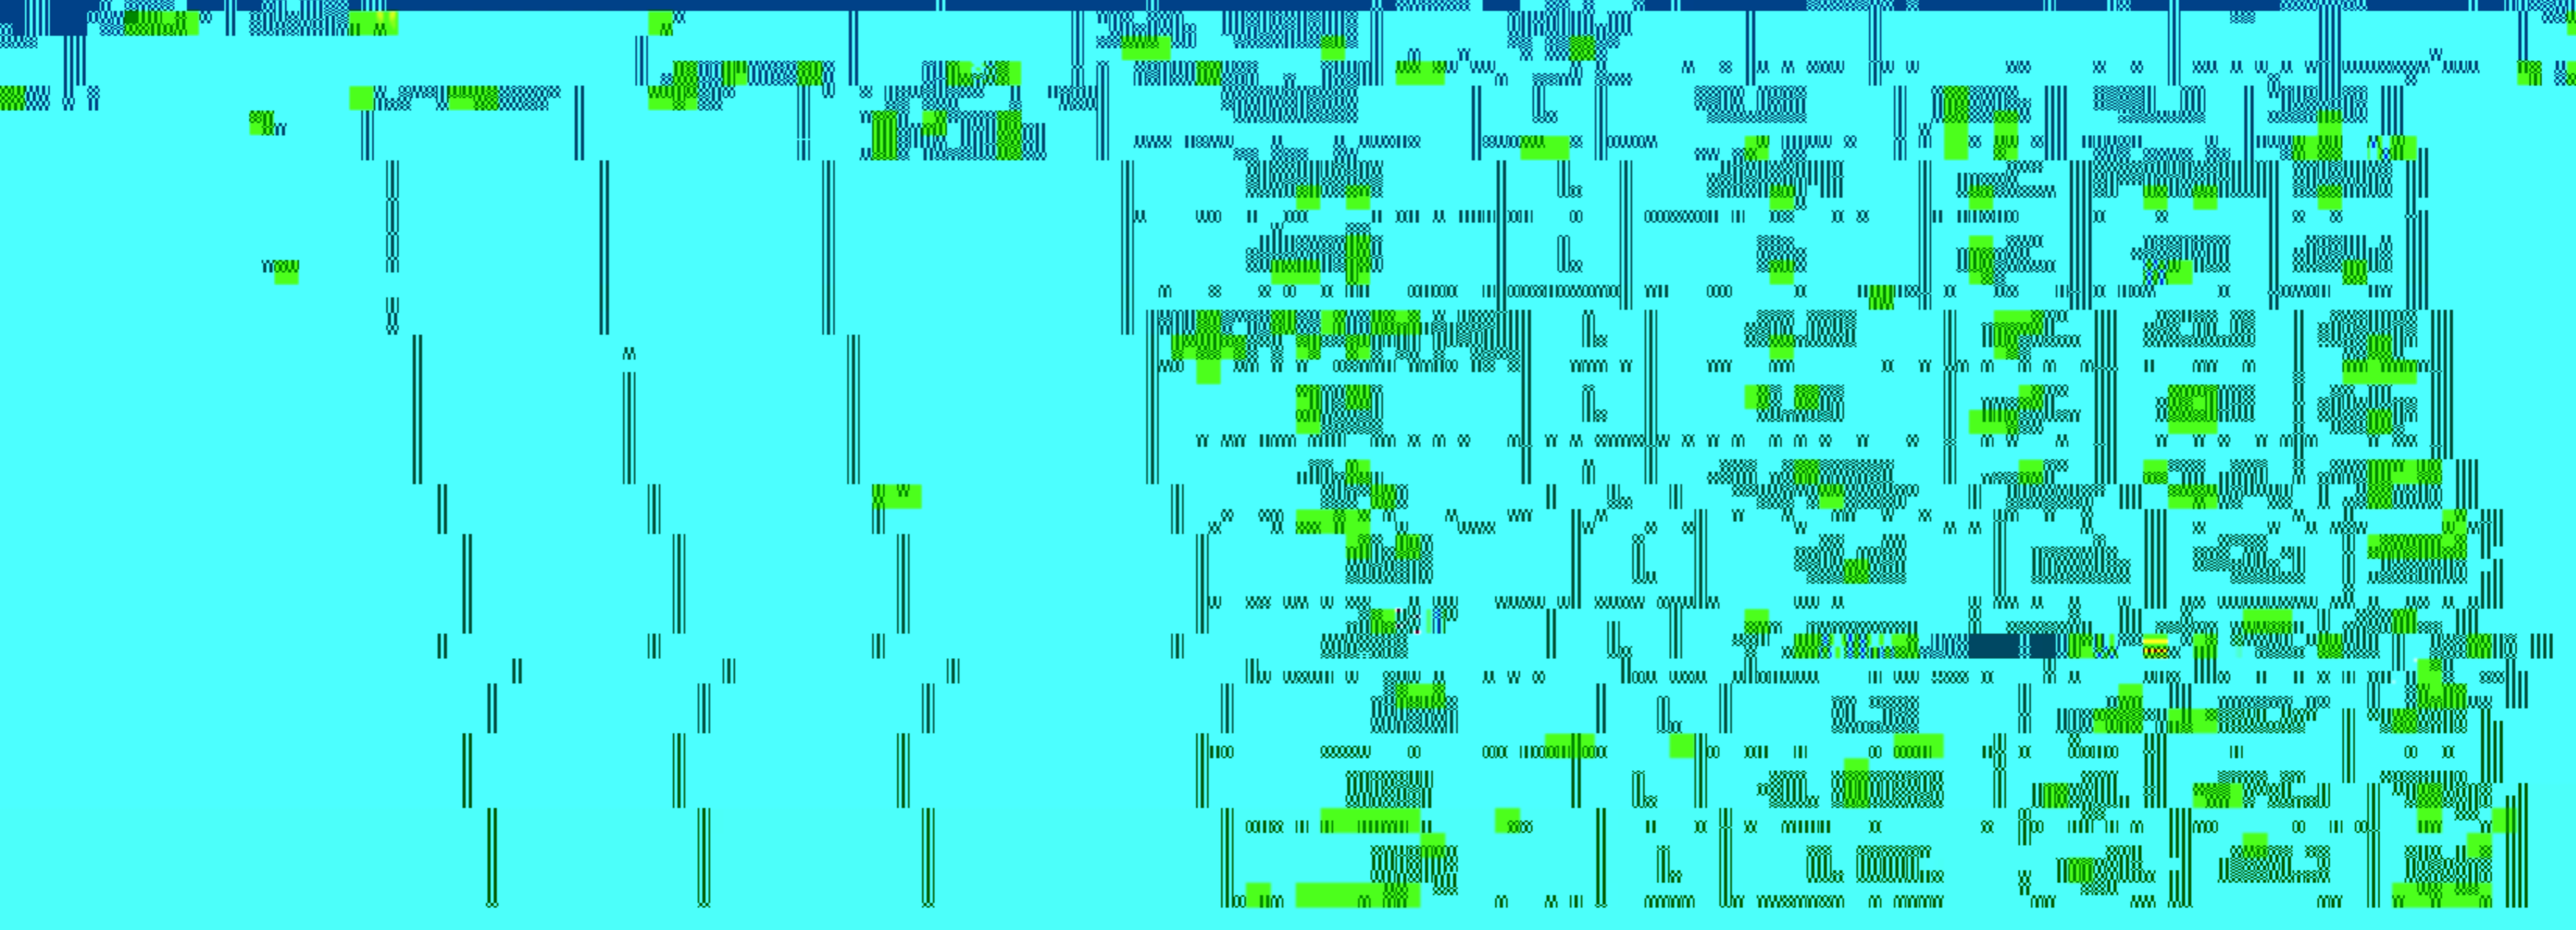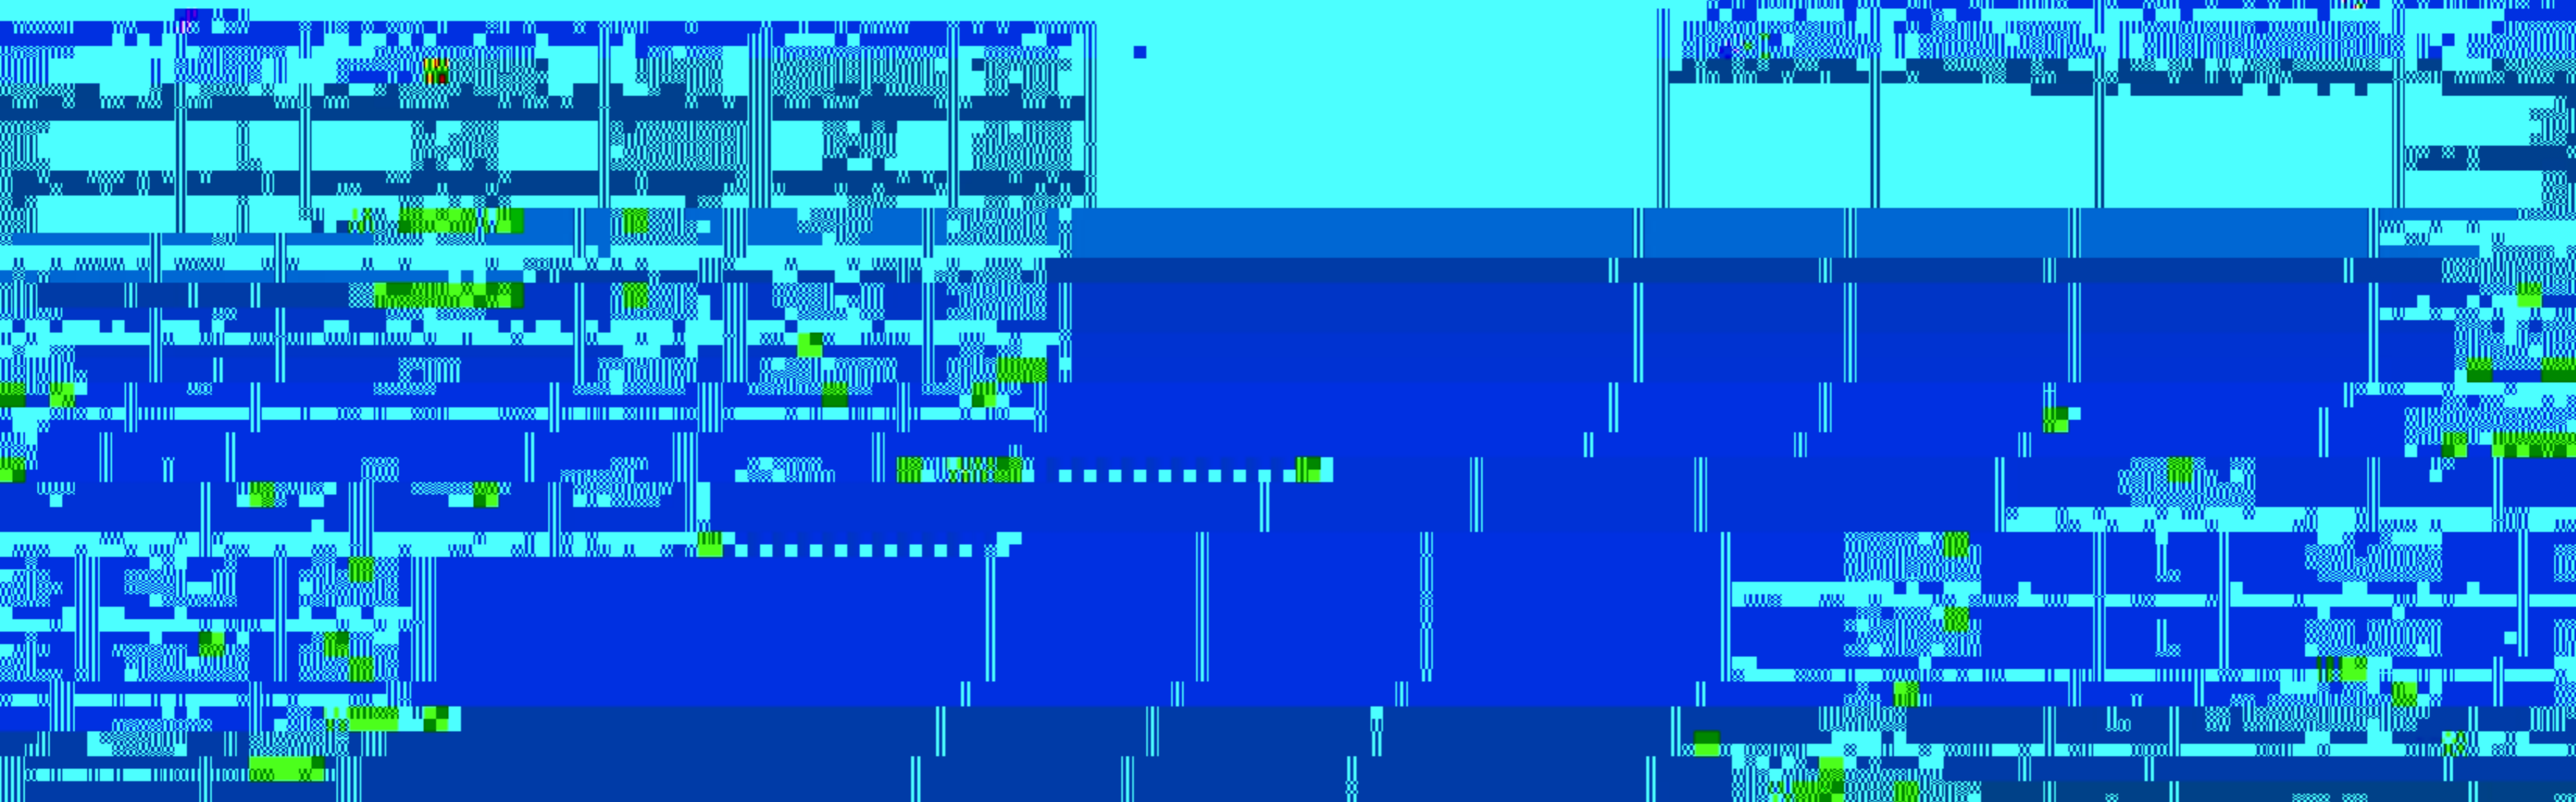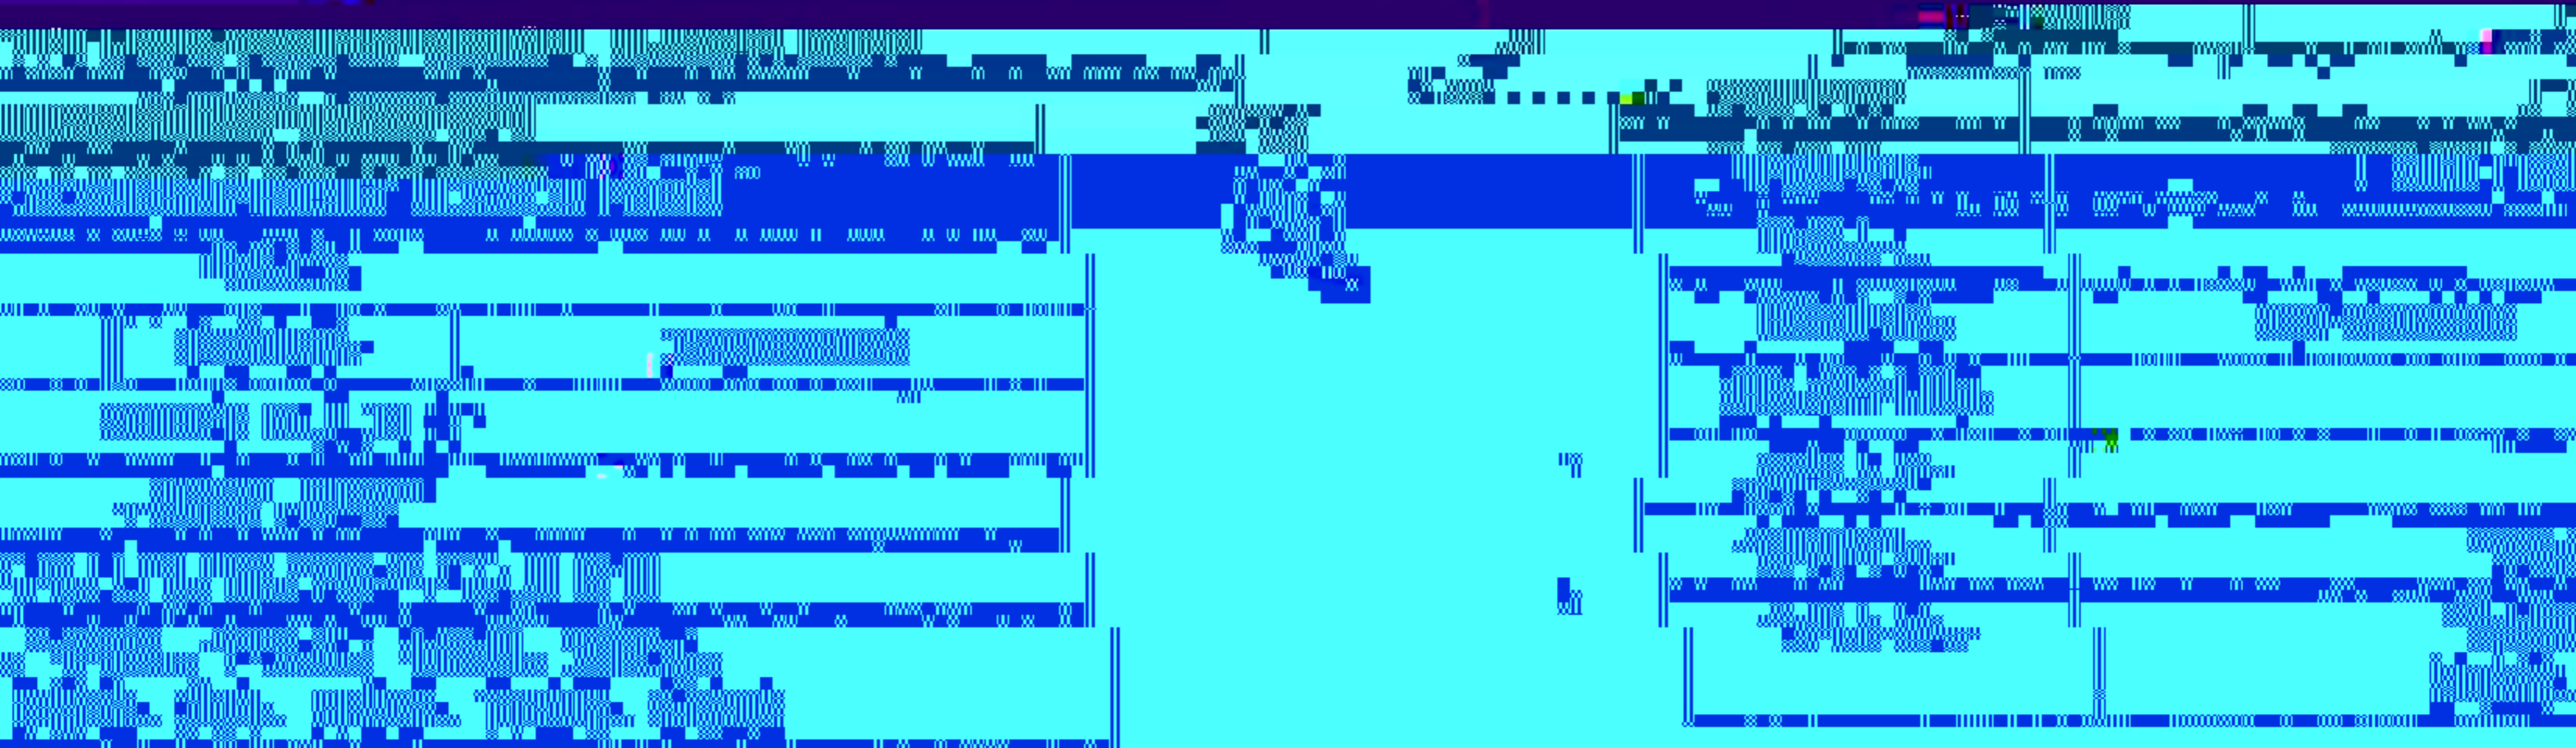

检测单位: 广州检验检测认证集团有限公司

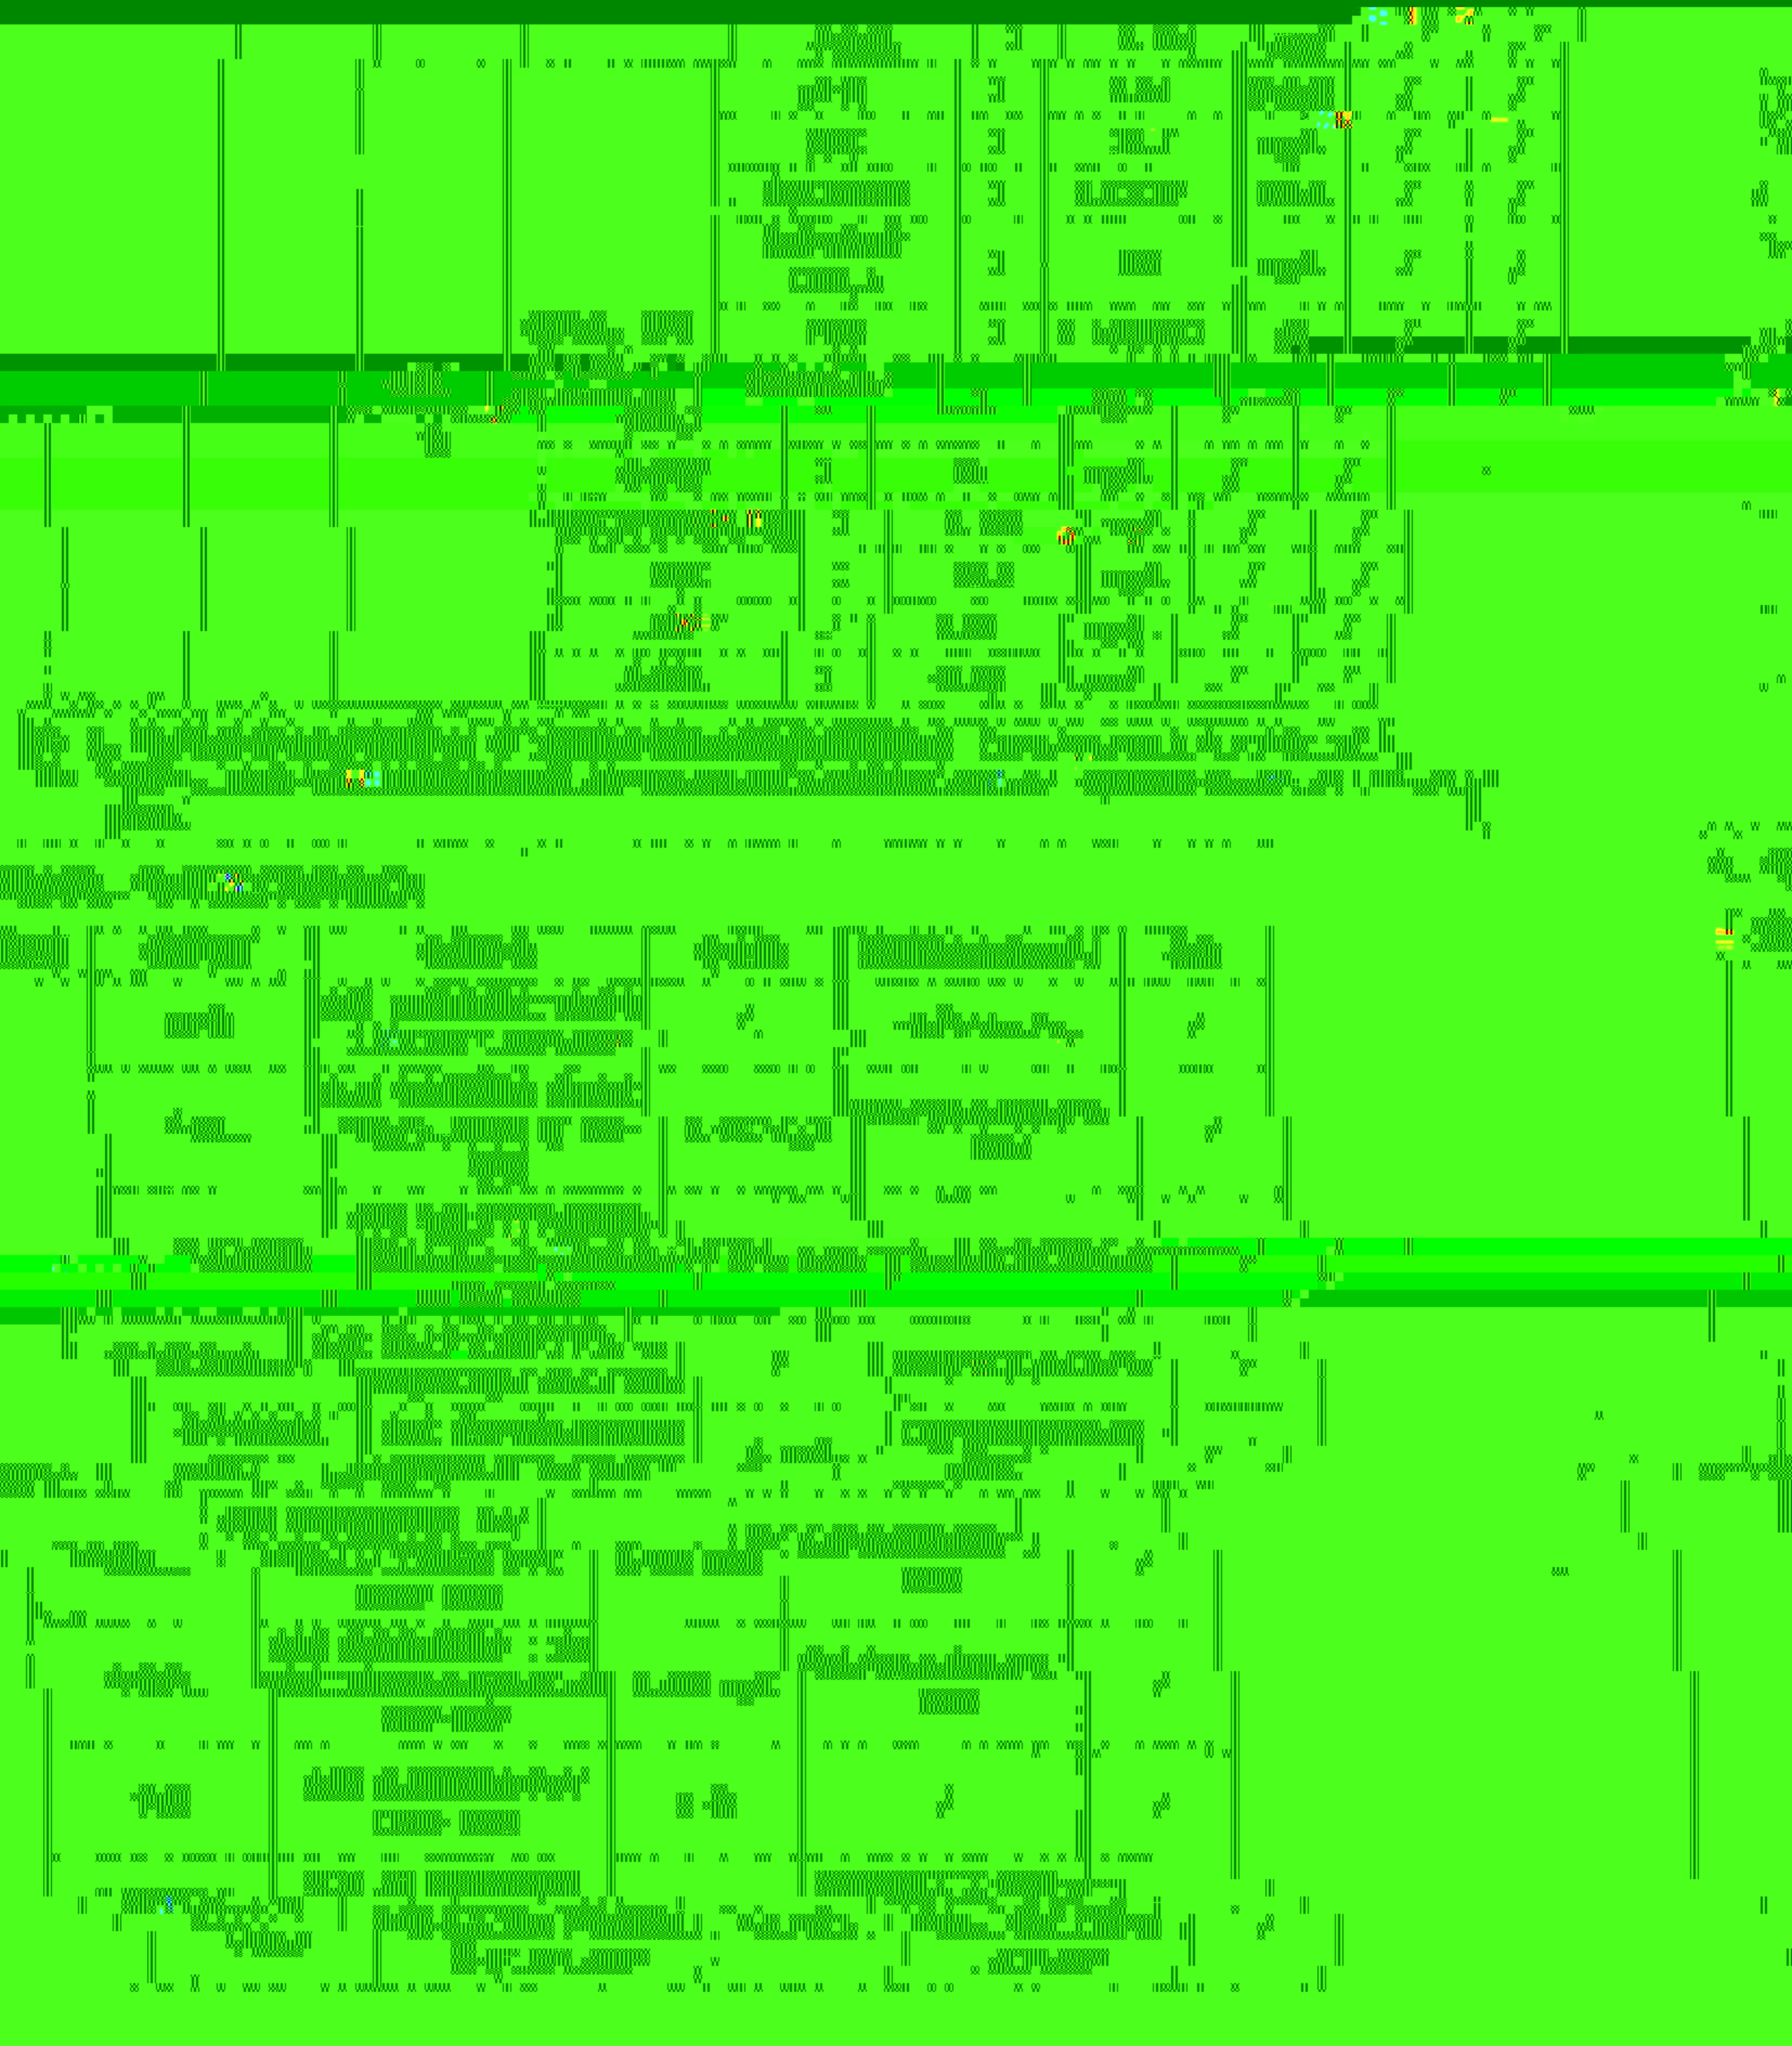

广州检验检测认证集团有限公司



补版)

总汞	水质 汞、砷、硒、铊和 锑的测定 原子荧光法 HJ 634-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光谱仪 /BAF-2000	/
----	--	--------------	----------------------	---

总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法 GB/T 11893- 1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
----	---	-----------	-----------------------	---

	石墨炉原子吸收法 (B)			
--	--------------	--	--	--

||

==|| ||

==|| ||

==|| ||

==|| ||

