


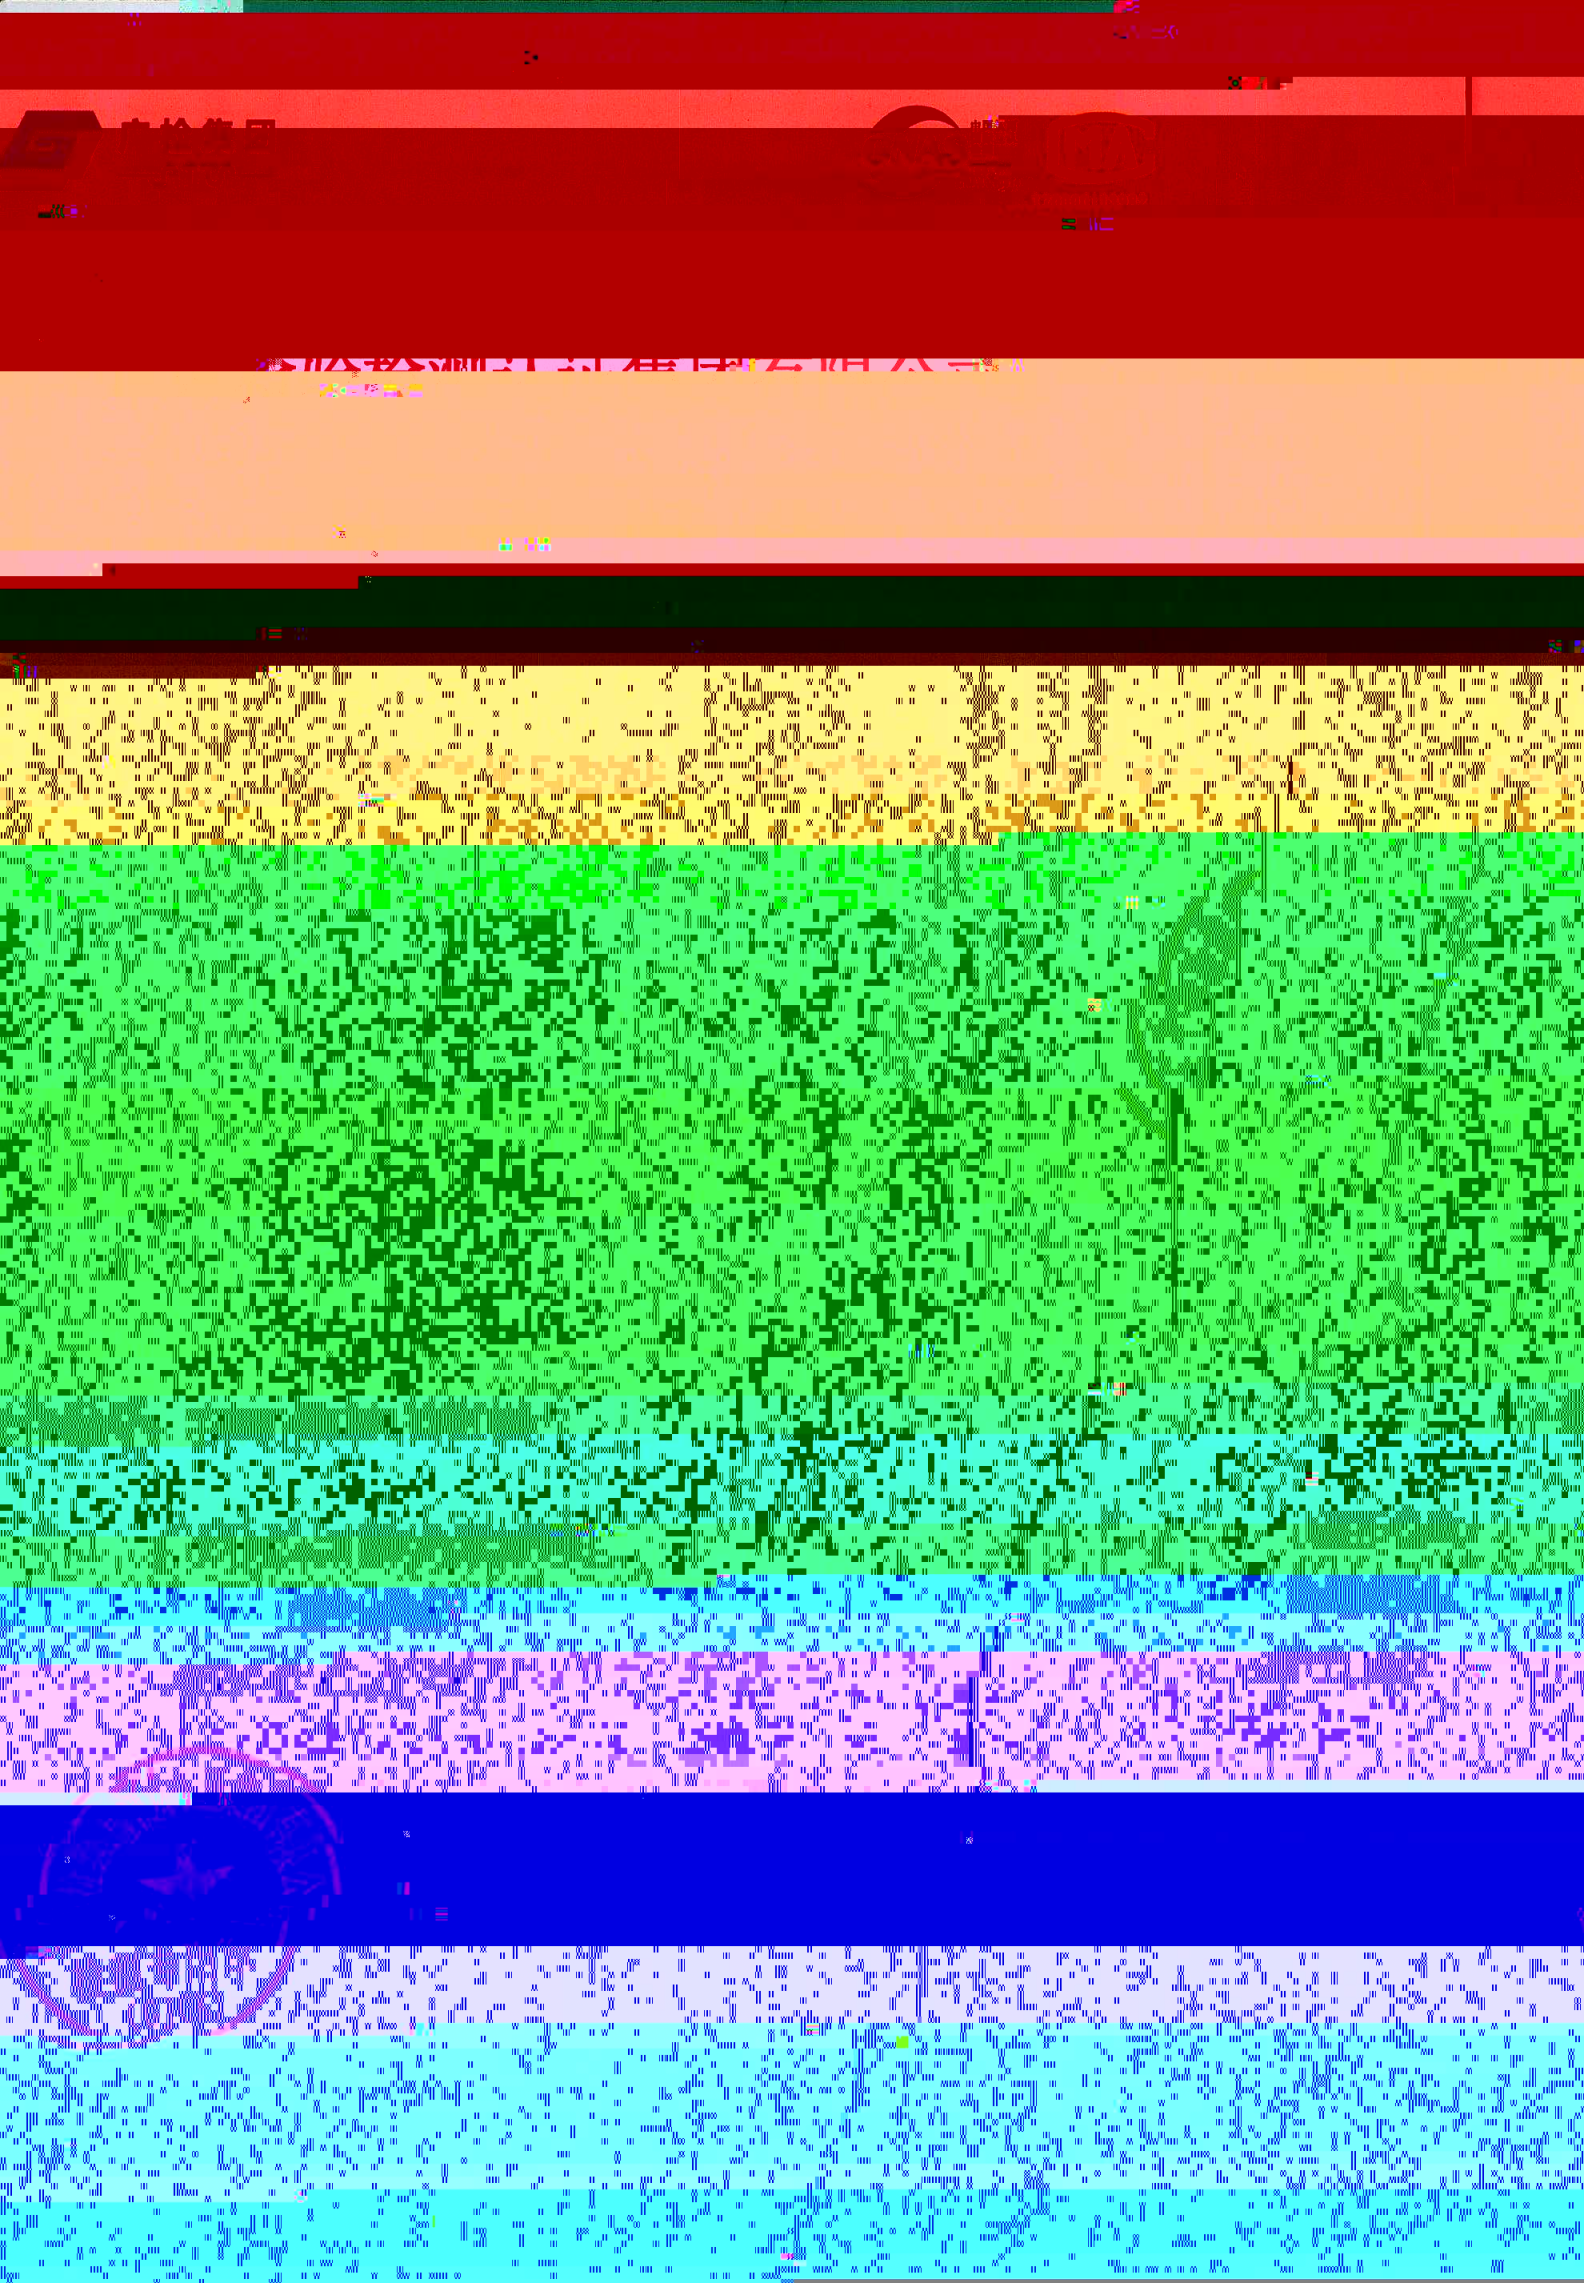

1. 基本信息

1.1 委托单位: 广州检验检测认证集团有限公司

1.2 检测项目: 广州检验检测认证集团有限公司

1.3 检测地点: 广州检验检测认证集团有限公司

1.4 检测日期: 广州检验检测认证集团有限公司

1.5 检测人员: 广州检验检测认证集团有限公司

1.6 检测仪器: 广州检验检测认证集团有限公司

1.7 检测方法: 广州检验检测认证集团有限公司

1.8 检测结果: 广州检验检测认证集团有限公司

1.9 检测结论: 广州检验检测认证集团有限公司

1.10 检测费用: 广州检验检测认证集团有限公司

1.11 检测备注: 广州检验检测认证集团有限公司

1.12 检测日期: 广州检验检测认证集团有限公司

1.13 检测地点: 广州检验检测认证集团有限公司

1.14 检测项目: 广州检验检测认证集团有限公司

1.15 检测人员: 广州检验检测认证集团有限公司

1.16 检测仪器: 广州检验检测认证集团有限公司

1.17 检测方法: 广州检验检测认证集团有限公司

1.18 检测结果: 广州检验检测认证集团有限公司

1.19 检测结论: 广州检验检测认证集团有限公司

1.20 检测费用: 广州检验检测认证集团有限公司

1.21 检测备注: 广州检验检测认证集团有限公司

1.22 检测日期: 广州检验检测认证集团有限公司

1.23 检测地点: 广州检验检测认证集团有限公司

1.24 检测项目: 广州检验检测认证集团有限公司

1.25 检测人员: 广州检验检测认证集团有限公司

1.26 检测仪器: 广州检验检测认证集团有限公司

1.27 检测方法: 广州检验检测认证集团有限公司

1.28 检测结果: 广州检验检测认证集团有限公司

1.29 检测结论: 广州检验检测认证集团有限公司

1.30 检测费用: 广州检验检测认证集团有限公司

1.31 检测备注: 广州检验检测认证集团有限公司

1.32 检测日期: 广州检验检测认证集团有限公司

1.33 检测地点: 广州检验检测认证集团有限公司

1.34 检测项目: 广州检验检测认证集团有限公司

1.35 检测人员: 广州检验检测认证集团有限公司

1.36 检测仪器: 广州检验检测认证集团有限公司

1.37 检测方法: 广州检验检测认证集团有限公司

1.38 检测结果: 广州检验检测认证集团有限公司


1.39 检测结论: 广州检验检测认证集团有限公司


1.40 检测费用: 广州检验检测认证集团有限公司

1.41 检测备注: 广州检验检测认证集团有限公司

1.42 检测日期: 广州检验检测认证集团有限公司

1.43 检测地点: 广州检验检测认证集团有限公司

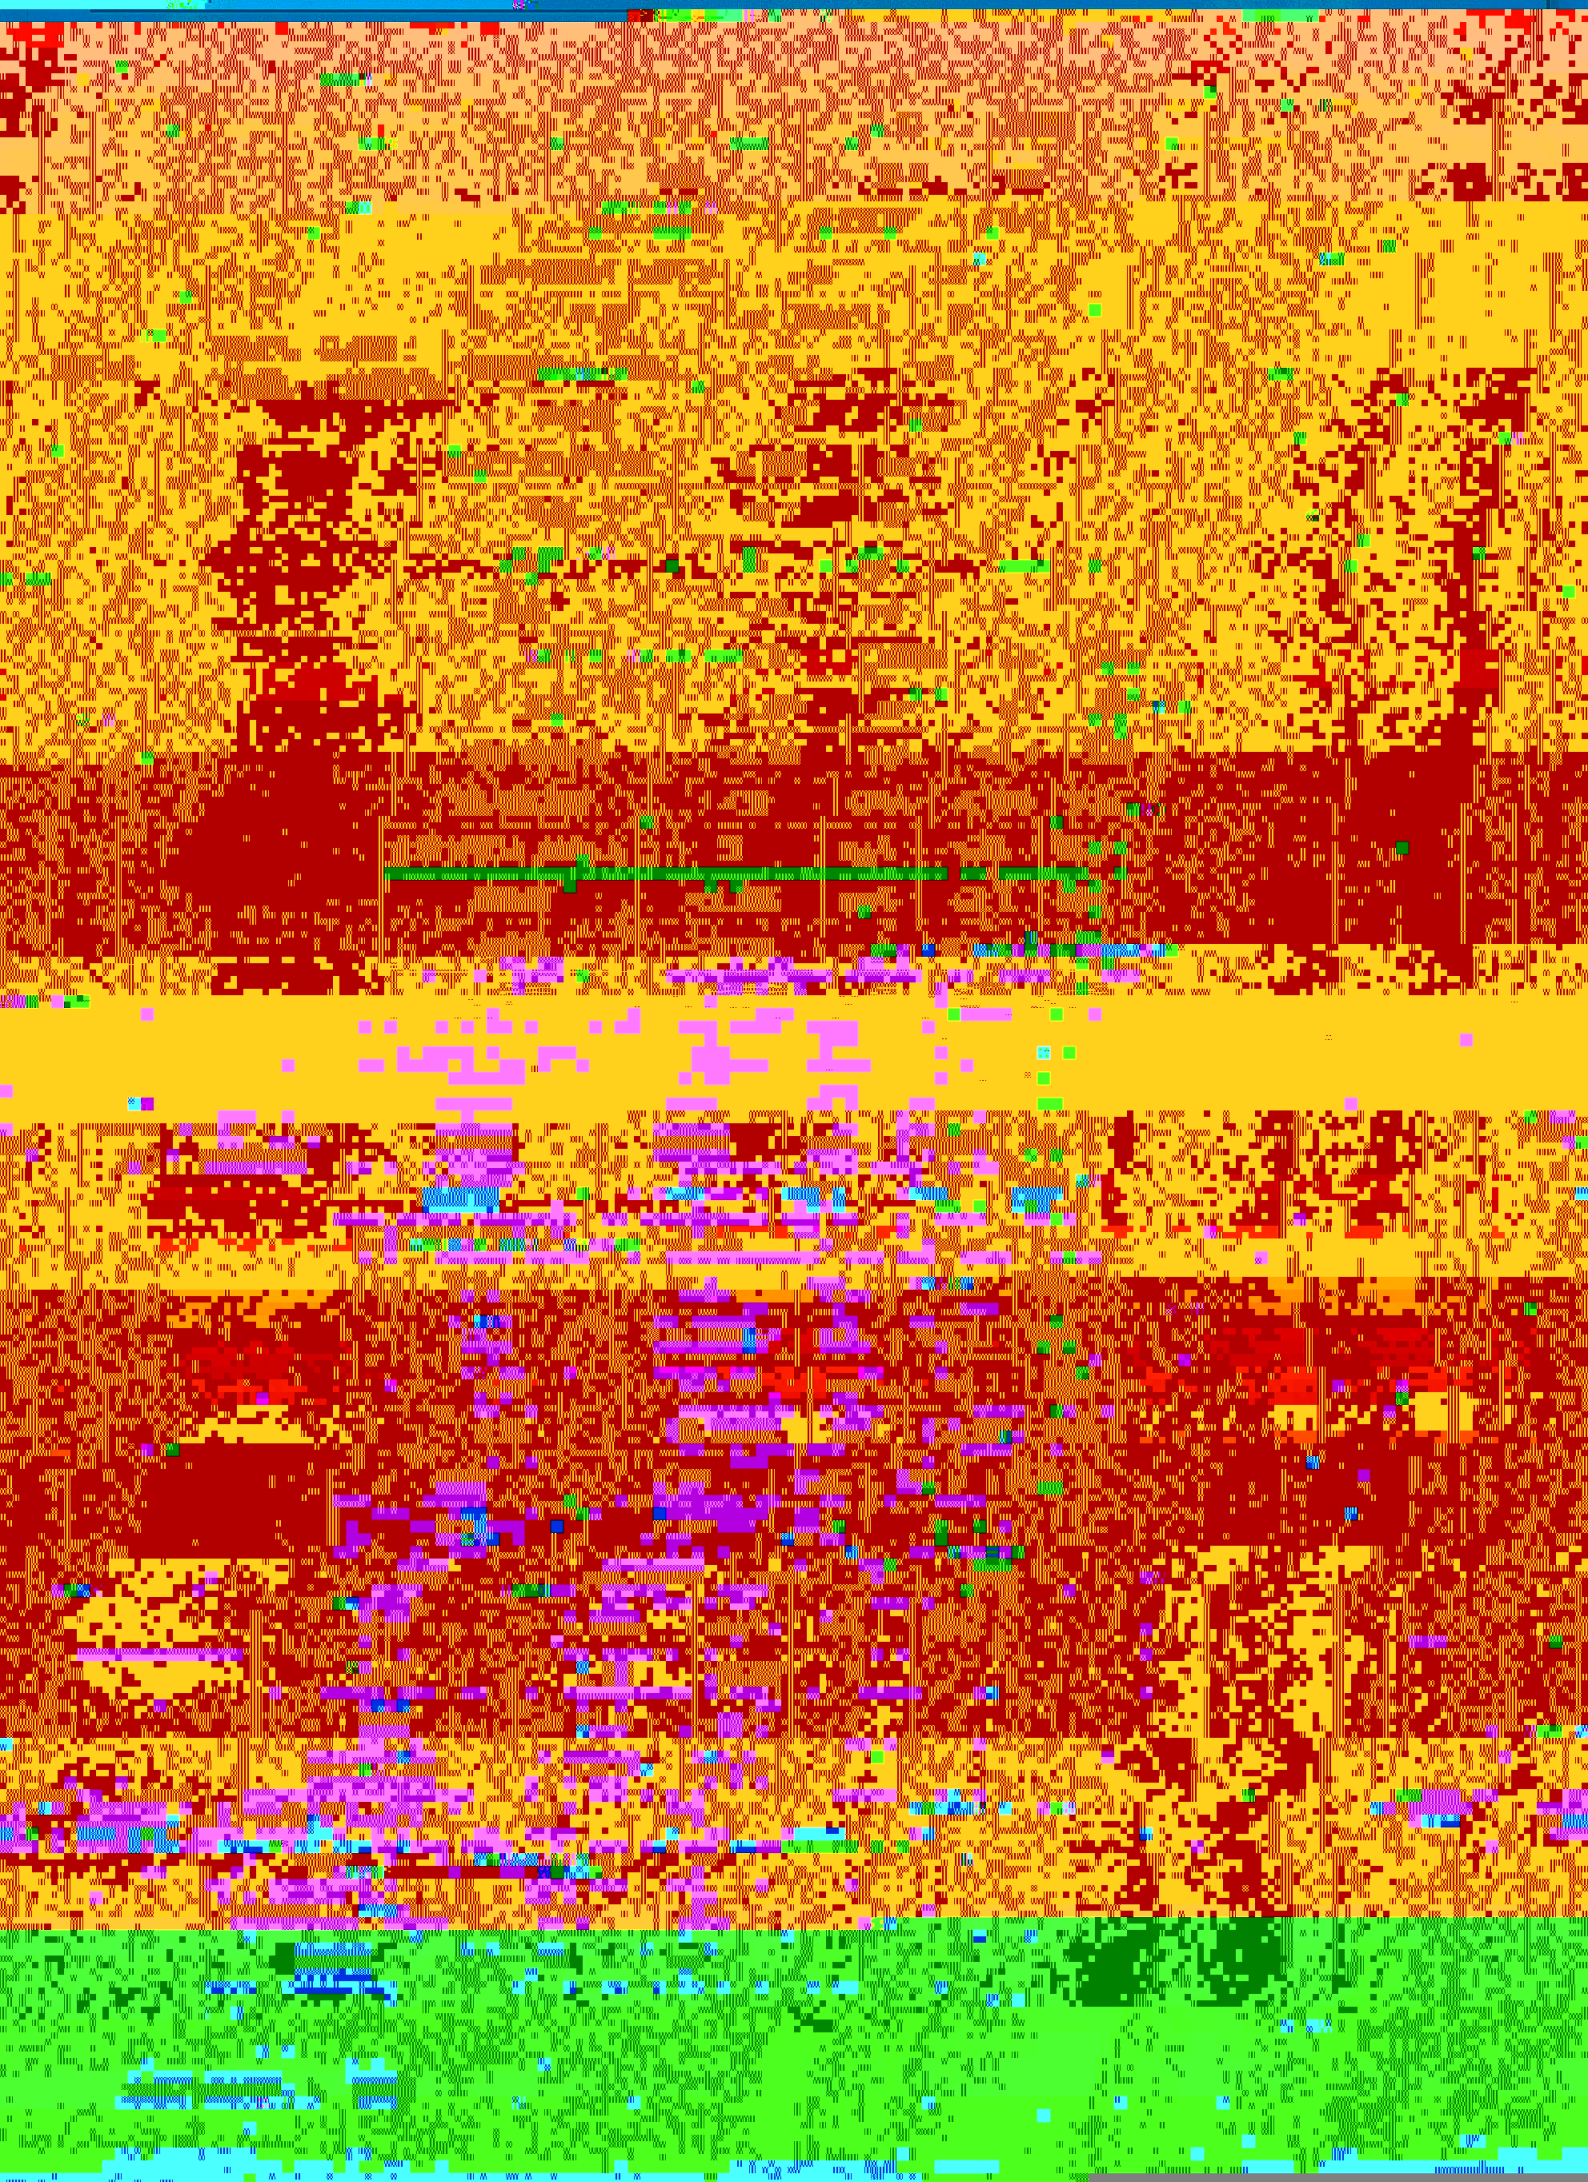

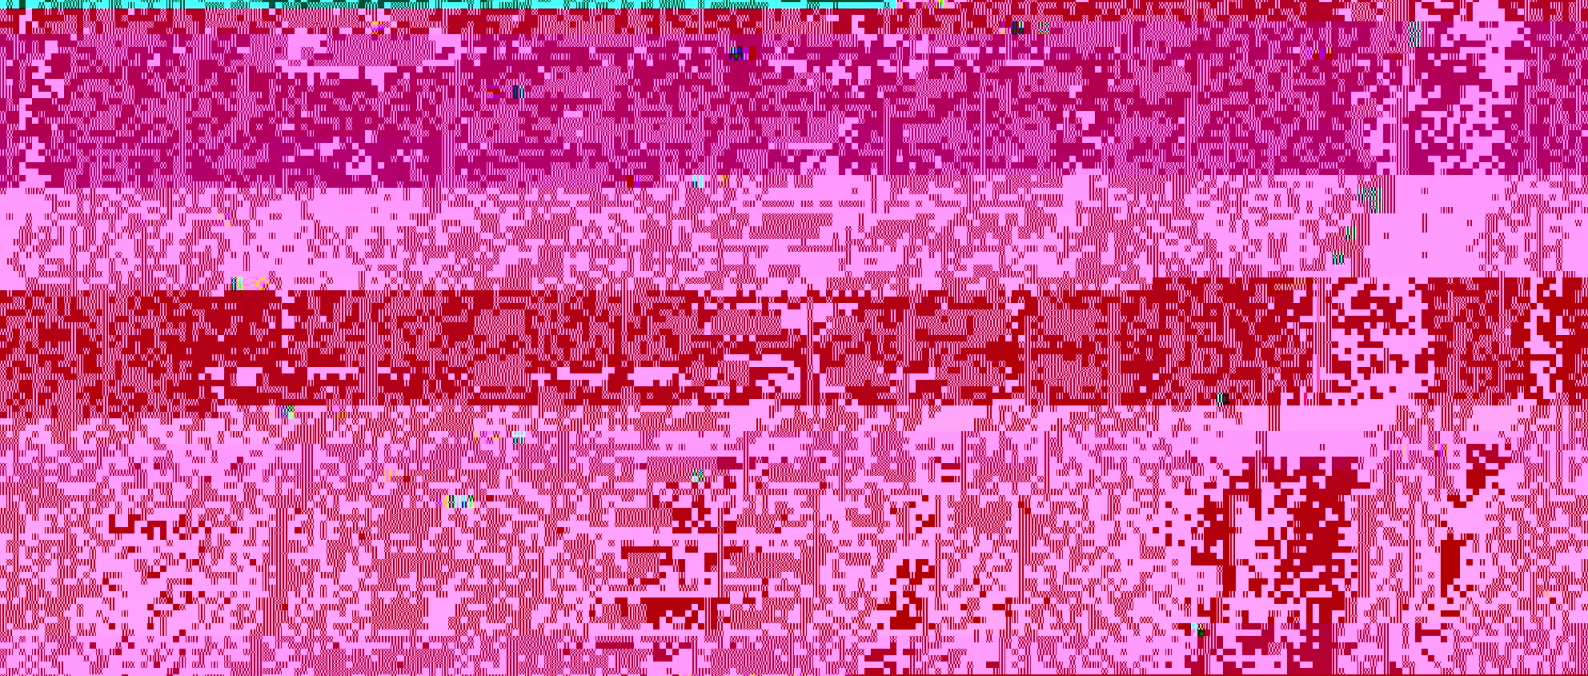

附录II



检测限及仪器信息

检测限: 0.01 mg/L

仪器名称: 哈希 DR/8900 分光光度计

仪器型号: DR/8900

仪器品牌: 哈希 (HACH)

仪器位置: 实验室

仪器状态: 良好

仪器校准: 合格

仪器维护: 正常

仪器使用: 正常

仪器存放: 正常

仪器运输: 正常

仪器回收: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

仪器报废: 正常

水质 阴离子表面活性剂的测

将包公出说

